

Instruksjoner for bruk for



Trappeklatrer av *motion cardio line 900 & motion cardio line 900 med*



motion stair 900
motion stair 900 med

Innhold

1.	Generelt	3
2.	Klassifisering av enhetene	3
3.	Sikkerhetsinstruksjoner	4
	Sikker installasjon av utstyret.....	4
	Sikker opplæring	5
	Indikasjoner og kontraindikasjoner	6
4.	Betjening av displayet	7
	Oversiktsvisning/tastefunksjoner	7
	Valg av program.....	8
	Pulssystemer.....	8
	Induktiv lading (valgfritt)	9
5.	Pleie, vedlikehold og service.....	9
	Veiledning for påvisning av feil (funksjonsfeil)	12
	Vedlikeholdsinstruksjoner for operatøren	12
	Vedlikehold av autorisert spesialist.....	12
	Kalibrering/vedlikehold	13
6.	Tekniske spesifikasjoner*	13
7.	Avhending	13
8.	Garanti	14

1. Generelt



Les denne brukerhåndboken med alle sikkerhetsinstruksjoner og advarsler nøye **før du bruker** treningsutstyret for første gang for å sikre sikker og riktig bruk. Ta vare på dette dokumentet for fremtidig referanse og gi det til andre hvis du gir utstyret videre.

Formålet med utstyret er kardiopulmonal trening og reproducerbar belastning av kroppen, f.eks. for diagnostiske og terapeutiske tiltak. Utstyret brukes hovedsakelig av brukere innen kardiologi, fysioterapi, idrettsmedisin og i hjemmet. En annen anvendelse er bruk for å bygge opp og styrke skjelettmuskulaturen, samt for å øke bevegeligheten i de berørte leddene under trening.

Utstyret muliggjør reproducerbar fysisk belastning av menneskekroppen og det kardiovaskulære systemet med henblikk på forebygging, rehabilitering og diagnostisering.

Tekst med grå bakgrunn indikerer tekstavsnitt som utelukkende omhandler utstyrsfunksjoner i treningslinjen.

2. Klassifisering av enhetene

- Enhetene til *cardio line med* er medisinsk utstyr **MD** i henhold til direktiv 93/42 EWG, klassifisert i klasse IIa. I bremsens kontrollområde er visningsnøyaktigheten +/- 5%.
- Apparaterne i *cardio-serien* er i samsvar med standarden DIN EN ISO 20957-1 og DIN EN ISO 20957-5; bruksklasse S (kommersiell bruk/studio) og H (hjemmebruk) med nøyaktighetsklasse A +/- 10 % og er utelukkende beregnet for fitness- og sportsbransjen.

Bare 1 person kan trene med utstyret om gangen; den maksimale brukervekten i henhold til typeskiltet må ikke overskrides.

3. Sikkerhetsinstruksjoner

Sikker installasjon av utstyret






Fig.1: Sidebilde av enheten med angivelse av de viktigste elementene.







- Plasser enheten på et fast, horisontalt, plant og sklisikkert underlag, og juster enheten med justeringsskruene slik at den ikke vakler.
- Det frie området rundt enheten må være minst 1 m større enn enhetens bevegelsesområde for å sikre sikker tilgang til og utgang fra enheten selv i nødstilfeller. Sikkerhetsavstandene kan imidlertid overlappe hverandre (se bildet).



- Plasser apparatet kun i tørre rom på 10°C .
- Sørg for at det ikke er elektromagnetisk stråling, f.eks. fra radioantenner, lysstoffrør osv., da dette kan påvirke pulsmålingen.
- Undersiden av rammen må alltid være fri for tilstrekkelig ventilasjon.
- Alle enhetene som er nevnt her er nettuavhengige. De genererer strømmen selv under drift eller forsynes med strøm under programmering av den innebygde standardkondensatoren. Kondensatoren lades ved trening og har en levetid på > 20000 sykluser.
- OBS: Følg alltid instruksjonene for pleie, vedlikehold og service i kapittel 5 i denne håndboken.

Sikker opplæring

- Før treningen starter, bør egnetheten for trening kontrolleres av en autorisert person, f.eks. en lege. Vær oppmerksom på punktet "Indikasjoner og kontraindikasjoner".
- Vær oppmerksom på at overdreven trening kan være skadelig.
- Hvis kvalme eller svimmelhet oppstår, må du slutte å trene umiddelbart og oppsøke lege.
- Trening på utstyret er kun tillatt med intakt hud.
- Når du trener, er tettsittende, lette sportsklær å foretrekke, slik at de ikke kan sette seg fast i deler av enheten under trening. Bruk alltid egnede sportssko for et sikkert fofeste på pedalene.
- Før du starter treningen, må du kontrollere at enheten står trygt, har defekte deler eller mulige manipulasjoner. Hvis du finner feil eller ikke er sikker, spør veilederen før du starter treningen.
- Før du starter treningen, må du sørge for at ingen er i nærheten av de bevegelige delene for å unngå å sette tredjeparter i fare. Spesielt må barn uten tilsyn holdes borte fra utstyret.
- **Forsiktig: Trinnene** som brukeren står på under øvelsen trekkes opp til den øvre startposisjonen av tilstrekkelig sterke fjærer. For å unngå skader forårsaket av at føttene hopper tilbake, må brukeren klatre opp på maskinen på følgende måte
 - Du står foran enheten og holder fast i styret med hendene.
 - Sett først en fot på pedalen og trykk den ned mot gulvet.
 - Du flytter kroppsvekten helt over på denne pedalen.
 - Trykk nå den andre pedalen mot gulvet med den andre foten.
 - Begge pedalene er nå nede
 - Begynn nå å bevege begge bena og gå inn i det funksjonelle området for trappebevegelsen. Hvis du gjør det riktig, vil du ikke treffe det øvre eller nedre endepunktet med pedalen.
 - Hvis du vil slutte å trene igjen, la deg gli ned med begge pedalene til du berører bakken.
 - Nå lar de en pedal komme sakte opp og utøver nok mottrykk.
 - Hvis pedalen er på øverste stopp, kan du sette foten ned på gulvet foran enheten og la den andre pedalen bevege seg oppover på samme måte, bremset.
 - Hvis den andre pedalen også er på toppen av stoppet, tar du foten av pedalen.
 - Øv deg på å gå på og av maskinen flere ganger slik at du kan bruke den trygt - selv om du har nådd et utmattelsesnivå fra treningen.

-  **Advarsel:** Pulsmålingssystemet kan svikte på grunn av systemet. Overdreven trening kan føre til farlige skader eller død. Hvis du føler deg uvel, må du slutte å trene umiddelbart og ta kontakt med lege eller terapeut.
-  **Advarsel: Apparatet** må kun brukes med hus og i tørre rom.
-  **Advarsel for valgfri strømtilkobling:** Bruk kun godkjente strømforsyningsenheter som er testet i henhold til IEC 60601-1 og godkjent av produsenten av enheten. Forsikre deg om at strømforsyningen er installert på en slik måte at det er vanskelig å koble den fra (f.eks. ved hjelp av gultanker, installasjon under enheten eller kabelkanaler, plassering av strømforsyningen i områder som er vanskelig tilgjengelige).
-  **Advarsel:** Hvis det medisinske utstyret endres, må det utføres egnede undersøkelser og tester for å sikre fortsatt sikker bruk. Ikke modifier utstyret uten tillatelse fra produsenten.

Indikasjoner og kontraindikasjoner

Før du begynner å trene, må du konsultere en lege eller terapeut for å sikre at du er i stand til å trene.

Eksempler på indikasjoner

- Bevegelighet i muskel- og skjelettsystemet
- Styrking av muskulaturen
- Styrking av det kardiovaskulære systemet

Eksempler på kontraindikasjoner

- Hjerte- og karsykdommer
- Smerter i muskel- og skjelettsystemet
- Under opplæringen:
 - Brystsmerter
 - Ubehag
 - Kvalme
 - Svimmelhet
 - Kortpustethet

Spør legen hvis du tar medisiner.

4. Betjening av displayet

Tre eller ni treningsprogrammer muliggjør individuell og variert trening med motion stair 900 og motion stair 900 med.

	stair 900 / 900 med
Grunnleggende utstyr	Hurtigstart, trening på tid, pulstrening
inkl. programpakke	Hurtigstart Kvalifisering Pulstrening + 6 flere programmer

Oversiktsvisning/tastefunksjoner



Fig. 2: Skjermvisning som forklarer knappefunksjonene, den faktiske visningen kan variere i farge, knappetilordningen er den samme.

Forklaring av knappene:


- **Hjem-knappen** er en fysisk knapp under skjermglasset. Den trykkes for å gå inn i hovedmenyen. Hvis du trykker lenge på HOME-knappen (minst 6 sekunder), tilbakestilles skjermens elektronikk.
- Trykk på PAUSE-knappen for å sette treningen på pause.
- Trykk på PLAY-knappen for å starte eller gjenoppta treningen.
- COOL-knappen stopper treningen umiddelbart. Et sammendrag av treningsresultatene genereres umiddelbart, vises og sendes om nødvendig til en kompatibel treningskontrollprogramvare.
- Bruk tasten "+" eller "-" for å øke eller redusere parametrene eller effektverdiene som skal stilles inn.
- Bruk **piltastene til å** navigere gjennom de tilsvarende menyene og bekrefte verdier eller innstillinger.
- Sveip/sveip-bevegelser navigerer gjennom programutvalget.

Avhengig av programmet vises noen av følgende parametere:

- Programmets navn.
- Tid: Opplæringstid som er fullført eller gjenstår.
- Puls: Pulsindikator ved bruk av et kompatibelt pulsbelte. Pulsindikatoren viser det aktuelle pulsområdet for programmer med mål- eller maks puls. Profilindikatoren i displayet viser utviklingen av intensitetsområdet under treningen.
- Watt: Effekten vises i watt. Parallelt tydeliggjøres intensiteten via en grafisk visning i profilen.

- km/t: Fiktiv hastighet vises i km/t.
- Hastighet: Pedalomdreininger per minutt.
- L/R (ikke med body 900/900 med): Kraftforholdet mellom venstre og høyre ben vises her i %.
- HRV: Hjerterefrekvensvariabilitet vises via RMSSD-verdien (krever **POLAR** H10-sensor).
- hhv: Pustefrekvens (krever **POLAR** H10-sensor)
- km: Lagt til eller gjenværende avstand. Visningen er i meter; fra 1000 m i trinn på 10 m (1,00 km).
- K-Cal: Tilført eller gjenværende kaloriforbruk.
- Nivå: Intensitetsnivå 1 - 21.
- Ø Hvis parametrene er utfyllt med dette symbolet, er de gjennomsnittsverdier.


Resultater

Etter fullføring av et treningsprogram eller for tidlig avslutning via COOL  vises resultatene på monitoren og en 3 minutters nedkjøling finner sted. Dette kan avbrytes via HOME-knappen.

Noen av verdiene er gjennomsnittsverdier (watt, km/t, turtall, puls, høyde/min), andre er kumulerte (km, K-Cal, tid, høyde). Gjennomsnittsverdiene er merket med symbolet Ø.

Disse resultatene gjør det mulig å overvåke personlig prestasjonsutvikling og fungerer dermed som motivasjon.

Valg av program

Det ønskede treningsprogrammet kan velges i hovedmenyen ved å trykke på det tilsvarende symbolet. Du kommer da til konfigurasjonssiden der du kan stille inn de tilsvarende treningsparametrene. Trykk på PLAY-knappen  for å bekrefte inntastingen og starte treningen. Du kan gå tilbake til hovedmenyen via hjem-ikonet eller hjem-knappen.

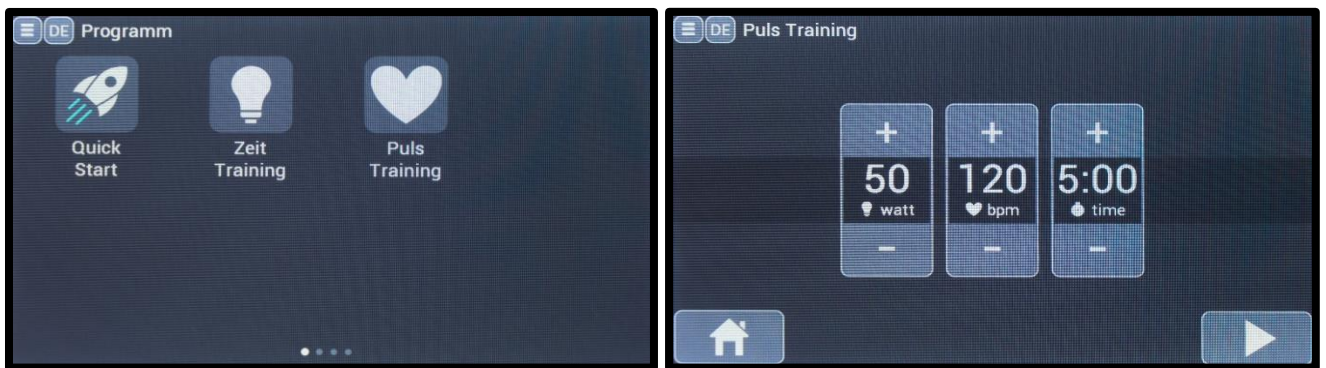




Fig. 3: Programvalg og konfigurasjon for manuell opplæring.

Pulssystemer



Apparatene til **motion cardio line 900** og **motion cardio line 900 med** har det originale **POLAR** pulssystemet, der signalregistreringen skjer ved hjelp av et pulsbelte som standard. Dette muliggjør individuell trening i forskjellige programmer. Den trådløse dataoverføringen til displayelektronikken er kodet (enten via 5 kHz eller  Bluetooth). Den nye **POLAR** "Auto-Pairing"-teknologien er basert på sikker og interferensfri dataoverføring via Bluetooth. Denne teknologien krever bruk av H10- eller H9-sendere. Andre parametere, som HRV og respirasjonsfrekvens, overføres også til monitoren via  Bluetooth - tilkoblingen.

Hvis de gamle senderne brukes, f.eks. T31-kodet, er det nedadgående kompatibilitet. Det bør imidlertid bemerkes at det kan være interferens med signaloverføringen via 5 kHz-teknologien.

Fargen på det blinkende hjertesymbolet gir en indikasjon på hvilken teknologi som brukes.

lyseblå=Bluetooth grønn=5kHz

ANT + ANT

Apparatene til **motion cardio line 900** og **motion cardio line 900 med** tillater i tillegg til overføringen av hjerterefrekvensen via 5kHz/, en valgfri dataoverføring via  . Ytelsespakken er nødvendig for dette.

Som standard er Polar 5kHz Bluetooth®-teknologien aktivert. For å aktivere overføring via ANT+ må bryteren "ANT+" i infoboksen () slås på (her merket med gult). Deretter kan det opprettes en forbindelse til en senderenhet som sender hjertefrekvensen via ANT+. Et mørkeblått blinkende hjertesymbol bekrefter hjertefrekvensoverføringen via ANT+.



Fig. 4: Aktivering av ANT+ for hjertefrekvensoverføring

Sikkerhetsinstruksjon i henhold til DIN EN ISO 20957

Advarsel. Pulsmålingssystemer kan være uøyaktige. Overdreven trening kan forårsake alvorlig helseskade eller død. Slutt å trene umiddelbart hvis du føler deg svimmel eller svak.

Induktiv lading (valgfritt)

En valgfri induktiv lademodul kan aktiveres på alle motion cardio line 900- og motion cardio line 900 med-enheter via "connect-pakken". Dette gjør det mulig å lade mobile enheter som er i samsvar med Qi-standarden (Φ) uten kontakt. Brukere av pacemakere eller implanterte defibrillatorer (ICD) anbefales å holde en minimumsavstand på 10 cm fra ladespolen.









5. Pleie, vedlikehold og service

Alt kardioutstyr fra emotion fitness er holdbart og krever lite vedlikehold for å fungere som treningsutstyr i lang tid. Det er imidlertid viktig at det nødvendige vedlikeholdet utføres samvittighetsfullt.

⚠ Advarsel: Enheten må kun åpnes av en autorisert spesialist.

Symboler og betydning

Sikkerhetsskilt	Referanse	Tittel
	ISO 7010-P017	Dytting forbudt
	ISO 7010-W012	Advarsel, elektrisitet
	ISO 7000-1641	Instruksjoner for bruk

<p>Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957</p>	<p>DIN EN ISO 20957</p>	<p>Sikkerhetsmelding Pulsmåling</p>
<p>Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.</p>		
	<p>ISO 7000-3082</p>	<p>Produsent</p>
	<p>ISO 7000-2497</p>	<p>Produksjonsdato</p>
	<p>ISO 7000-0632</p>	<p>Temperaturgrense</p>
	<p>ISO 7000-2620</p>	<p>Luftfuktighet, begrensning</p>
	<p>ISO 7010-W001</p>	<p>Generelt advarselsskilt</p>
	<p>ISO 7010-M002</p>	<p>Følg bruksanvisningen</p>
	<p>IEC 60417-5840</p>	<p>Type B anvendt del (gjelder sete, pedaler og styre)</p>
	<p>ISO 15233</p>	<p>Medisinsk utstyr</p>

Sikkerhetsnivået til enhetene kan bare opprettholdes hvis enhetene kontrolleres regelmessig for skader og slitasje. Defekte deler må skiftes ut umiddelbart, og enheten må stenges ned inntil den er reparert.

Feildiagnose

Følgende feilmeldinger kan forekomme. Hvis feilen vises gjentatte ganger, kan tiltakene nedenfor hjelpe. Hvis disse ikke fører til suksess, bør produsenten og om nødvendig programvareprodusenten kontaktes.

Feilmelding	Tiltak	Berørte enhetstyper
"RFID-feil"	<ul style="list-style-type: none">RFID-nummer, dvs. nummeret på transponderen er for kort eller for langt.Det oppstod en feil under lesing av RFID-nummeret. → bruke en annen transponder	Alle ergometre
"Hjertesensor?"	Monitoren ønsker å starte et program som krever at en pulssensor bæres. Hvis ingen sensor blir funnet, vises denne meldingen.	Alle ergometre
"USB-problem"	Radiomeldingen ble sendt fra radiomodulen på monitoren til radiomodulen på PC-en (dvs. mottakermodulen bekreftet mottak av meldingen), men det kom ikke noe svar fra PC-en etter den angitte tidsperioden: → Start PC-en på nytt og koble USB-dongelen til PC-en igjen. Start om nødvendig programvaretjenesten på nytt.	Alle ergometre
"Radioproblem"	<ul style="list-style-type: none">Enheden mottar ikke svar fra USB-dongelen. Oppmerksomhet! Denne feilmeldingen kan også vises hvis meldingen som sendes fra dongelen til monitoren er feil (f.eks. feil format eller meldingen er ufullstendig). → Start PC-en på nytt og koble USB-dongelen til PC-en igjen. Start om nødvendig programvaretjenesten på nytt.	Alle ergometre
"NDEF err: lengde"	<ul style="list-style-type: none">Meldingen som finnes på NFC-taggen (dvs. meldingen som sendes fra smarttelefonen) er for lang. → Kontakt programvareprodusenten eller produsenten av enheten	Alle ergometre
"NDEF err: verify" (NDEF feil: verifiser)	<ul style="list-style-type: none">Det var ikke mulig å få tilgang til NFC-brikken. Dette er et autorisasjonsproblem når du får tilgang til NFC-brikken via skjermen ved hjelp av superpassordet. → Kontakt produsenten eller programvareprodusenten	Alle ergometre
Manglende verdi: XX (XX=nummer)	<ul style="list-style-type: none">En nødvendig innstillingsparameter ble ikke sendt til ergometeret av PC-programvaren → Kontakt produsenten eller programvareprodusenten.	Alle ergometre
Verdi XX utenfor området (XX=nummer)	<ul style="list-style-type: none">En nødvendig innstillingsparameter ble sendt utenfor det tillatte området fra PC-programvaren til enheten → Kontakt produsenten eller programvareprodusenten.	Alle ergometre

Veiledning for påvisning av feil (funksjonsfeil)

Hvis det oppstår feil på apparatet som du ikke kan klassifisere, ta kontakt med emotion fitness GmbH & Co.KG. For hver feilmelding bør du ha serienummeret og modelltypen til det defekte apparatet klart, da dette kan være viktig for å kunne stille riktig diagnose og fremfor alt for å kunne levere de riktige reservedelene til deg!

Vedlikeholdsinstruksjoner for operatøren

Ideelt sett bør du inspisere enheten visuelt før hver bruk, men minst daglig, og være spesielt oppmerksom på defekte deler, løse tilkoblinger og atypiske lyder.

Følgende kontroller må utføres minst hver sjette måned:

- Inspiser visuelt alle synlige skjøter, samt sveiser.
- Rengjør enheten grundig.
- Kontroller at alle skrueforbindelser er tette.
- Kontroller pedalenes integritet og styrke.

Generelt sett:

- Rengjør plasthuset og rammedelene regelmessig etter behov med en fuktig klut og mild såpe, og tørk av igjen.
- Bruk av sprayflasker med rengjøringsmidler er ikke tillatt; det har vist seg at enhetene aldri blir tørre på utilgjengelige steder. Rustangrep kan ikke utelukkes ved denne prosedyren.
- Pass på at det ikke kommer væske inn i monitorhuset,
- Bruk kun mikrozid® sensitive wipes desinfeksjonsservietter (<http://www.schuelke.com/>) til nødvendig desinfeksjon av utstyret.
- Displayet kan vise en kondensatorspenning som er for lav, slik at en funksjon uten bremsestrøm ikke kan garanteres på en sikker måte. Du kan lade opp kondensatoren ved å trække med høyere belastning eller med en strømforsyningsenhet som er godkjent av produsenten av apparatet.
- Kontroller at husfestene er tette.
- Vi anbefaler en regelmessig visuell inspeksjon av alle deler av enheten, spesielt skruer, sveiser og andre fester.
- Kontroller at apparatets føtter sitter godt fast.
- Bruk kun originale reservedeler - kontakt oss for dette.

Vedlikehold av autorisert spesialist

I tilfelle problemer med enheten som du ikke kan løse selv på en enkel måte, må du alltid kontakte emotion fitness-tjenesten. Den autoriserte tjenesten vil hjelpe deg raskt og kompetent eller gi deg instruksjoner.

Kalibrering/vedlikehold

På ellipsemaskiner og trappemaskiner (cross og trapper) er det ikke lovpålagt med MTK for brukeren. Dette er fordi kroppsvekten har innflytelse på den resulterende kraften på disse maskinene. emotion fitness GmbH & Co KG tilbyr å kalibrere bremsekraften på forespørsel.

I tillegg anbefaler vi vedlikehold med inspeksjon av sikkerhetsrelevante komponenter (STÜ) av autoriserte medarbeidere/partnere **hver 12. måned**.

Dette avsnittet viser til den juridiske situasjonen i Tyskland. Vennligst sjekk gjeldende lover for bruk av medisinsk utstyr i ditt land.

Utstyr med suffikset "med" er i samsvar med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. De bærer derfor CE-merket og nummeret til det meldte organet.

Distributøren/operatøren er ansvarlig for å utføre vedlikehold, service og kalibrering, samt eventuelle inspeksjoner i samsvar med gjeldende regionale lover og forskrifter der utstyret befinner seg! Din lokale autoriserte forhandler kan også gi ytterligere informasjon.

6. Tekniske spesifikasjoner*

Enhetstype	Dimensjoner (L/B/H)	Vekt	Maks. brukervekt	Sikker arbeidsbelastning
motion stair 900 motion stair 900 med	102 cm x 73 cm x 160 cm	79 kg	150 kg	229 kg

Motstandssystem: nettuavhengig bremsesystem

Effektområde: 4-27 m/min. Synkehastighet

Frihjul: tilgjengelig

Følgende EU-direktiver er oppfylt:

2001/95/EF Direktiv om generell produktsikkerhet

93/42/EØF direktiv om medisinsk utstyr klasse IIa (kun oppfylt for utstyr med suffikset med)

2014/30EU EMC-direktivet

Følgende standarder ble brukt:

DIN EN ISO 20957-1 Nøyaktighetsklasse A, bruksklasse SH; DIN EN ISO 20957-5;

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Verdiene kan variere på grunn av enhetsendringer og opsjoner.

Vi tar forbehold om tekniske og optiske endringer samt trykkfeil.

7. Avhending

Ved inngåelse av kjøpekontrakten anses det som avtalt at bedriftskunder selv skal avhende de EU-direktiv 2002/96/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr selv.

8. Garanti

Dette er basert på den lovbestemte garantien.

emotion fitness GmbH & Co KG, som distributør av dette produktet, tilbyr gratis service i 12 måneder på deler og arbeid for profesjonelle brukere hvis riktig bruk og pleie som angitt i denne brukerhåndboken kan bekreftes. I ytterligere 12 måneder leverer emotion fitness GmbH & Co KG gratis reservedeler.

Garantikravet utløper hvis produktet har blitt vedlikeholdt eller reparert av uautoriserte personer. Så snart et garantikrav oppstår, bør du umiddelbart informere emotion fitness GmbH & Co KG om dette skriftlig eller via e-post. Informasjon om apparatets serienummer, kjøpstidspunkt, en detaljert beskrivelse av feilen og forsyningskilden må oppgis av eieren av apparatet.

emotion fitness GmbH & Co KG vil sørge for en tjeneste, men forbeholder seg retten til å bestemme typen tjeneste.

Følgende prosedyrer kan tenkes:

1. Tjenesten utføres på stedet av vår tjeneste.
2. vi sender ønsket reservedel.
3. Vi sender en erstatningsenhet.

De defekte delene skal returneres til oss umiddelbart av kunden. Ellers vil de leverte reservedelene bli fakturert.

Hvis årsakene ligger utenfor garantien, forbeholder emotion fitness GmbH & Co KG seg retten til å belaste alle reparasjonskostnader.

Noen slidedeler dekkes ikke av garantien. Dette gjelder spesielt sete, krank og krankfeste, pedaler, pedalstopper, møbelstoffer og gripegummi på styret. **POLAR** pulssystemer leveres med den lovbestemte garantien.

Disse garantibestemmelsene skal ikke på noen måte påvirke de generelle lovbestemte kravene. Våre generelle leveringsbetingelser, som endret fra tid til annen, kan ses og lastes ned fra vår nettside www.emotion-fitness.de.

CE 0633

Takk for tilliten!

emotion
FITNESS

Produsent

emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Straße 68

67691 Hochspeyer, Deutschland

Tlf +49 (0) 6305-71499-0

Faks +49 (0) 6305-71499-111

Internett: www.emotion-fitness.de

E-post: info@emotion-fitness.de

Produsent EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

